


Protokollblatt – Nagelsches Anomaloskop

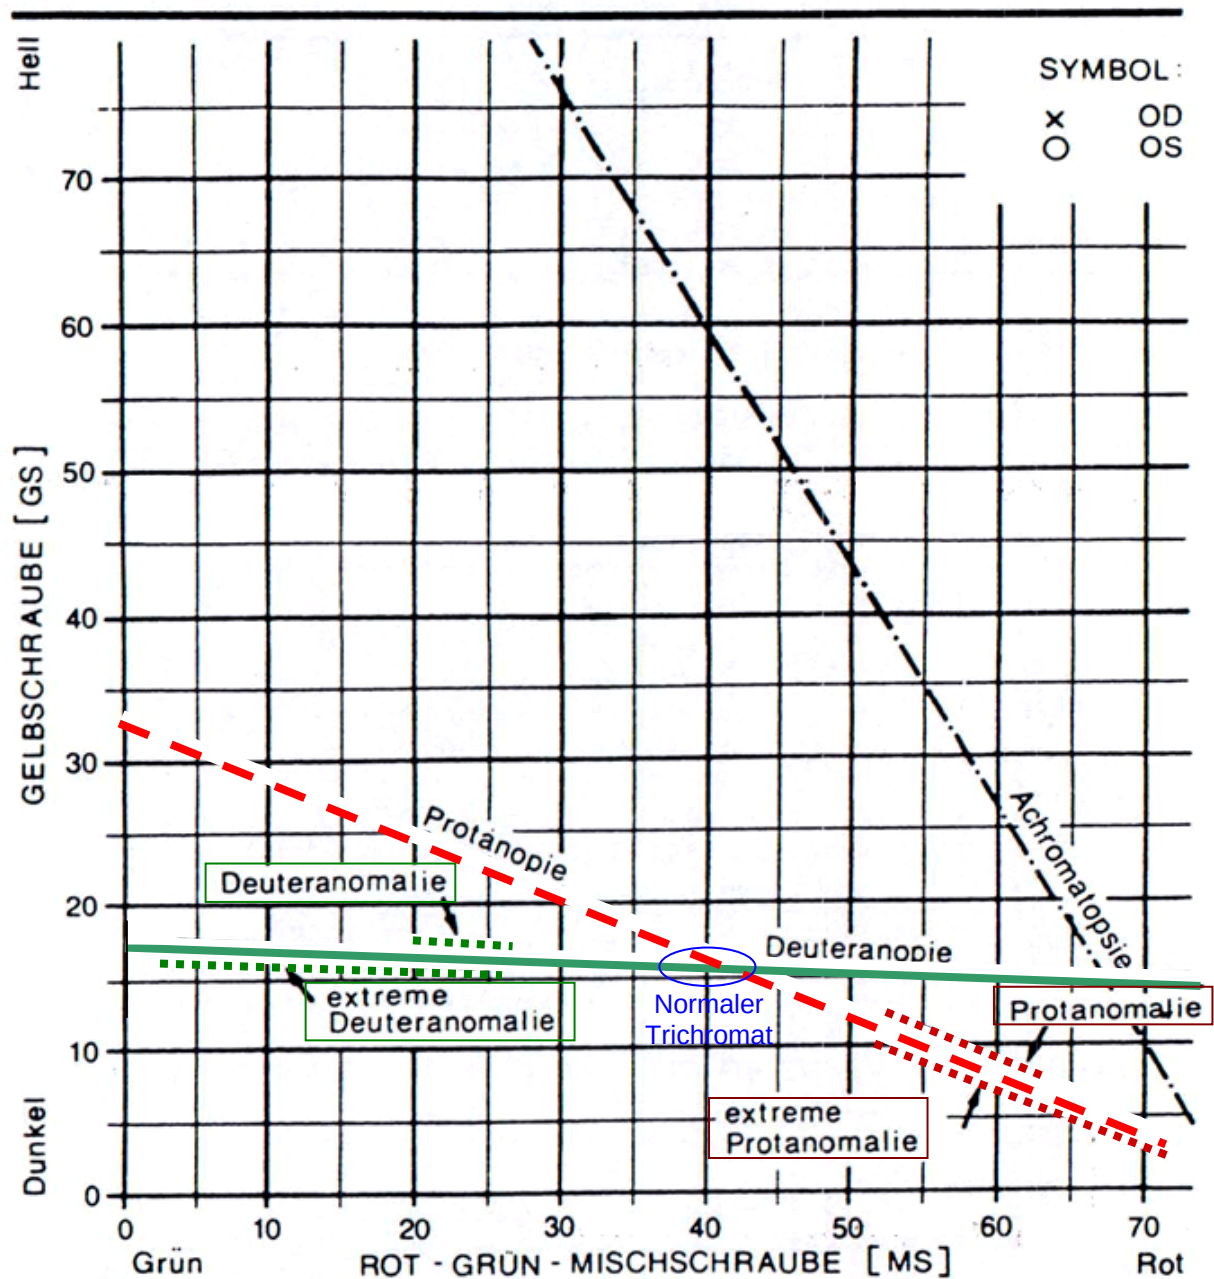

ANOMALQUOTIENT

ANHALTSWERTE

$$AQ = \left[\frac{73 - MS}{MS} \right] : 0.825 = \boxed{}$$

0.74 – 1.33 Normal
2.0 – 20.0 Deuteranomal
0.6 – 0.11 Protanomal

Gesamtbewertung

Datum:

Unterschrift: